

# HALO2

HI9810392

## Medidor de pH Wireless para Chocolate

com elétrodo especializado incorporado



Foodcare

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

**HANNA**<sup>®</sup>  
instruments

## Estimado Cliente

Obrigado por escolher um produto Hanna Instruments.

Por favor leia este Manual de Instruções cuidadosamente, antes de utilizar o instrumento.

Este manual fornece-lhe toda a informação necessária para que possa utilizar o instrumento corretamente, assim como uma ideia precisa da sua versatilidade.

Se necessitar de mais informações técnicas não hesite em contactar para [assistencia@hanna.pt](mailto:assistencia@hanna.pt) ou visite a nossa página [www.hanna.pt](http://www.hanna.pt)

## ÍNDICE

1. Exame Preliminar .....	4
2. Especificações .....	4
3. Descrição Geral e Finalidade de Utilização .....	5
Modo de Funcionamento .....	5
Características da sonda .....	5
4. Descrição Funcional & Ecrã LCD .....	5
5. Operações Gerais .....	6
Ligar e Desligar o medidor (ON/OFF) .....	6
Substituição da Pilha .....	6
6. Definições .....	6
Unidade de Temperatura .....	6
Auto-Off Interval .....	6
Pontos de Calibração .....	6
Conjunto de Padrões .....	6
Resolução de pH .....	6
Modo <b>Bluetooth®</b> Wireless .....	6
Emparelhamento Bluetooth .....	7
Data e Hora .....	7
7. Bluetooth .....	7
8. Aplicação Hanna Lab .....	7
Identificar uma medição (tag) .....	7
9. Calibração .....	7
Diretrizes para a Preparação .....	7
Procedimento .....	7
Medidor autónomo (Calibração até três pontos) .....	8
Com a App Hanna Lab (Calibração até quatro pontos) .....	8
10. Cuidados e Manutenção .....	8
Encher o eletrodo .....	9
Armazenamento .....	9
11. Mensagens de Aviso e Erros .....	9
12. Abreviaturas .....	9
13. Acessórios .....	10
Recomendações de Utilização .....	10
Garantia .....	10
Certificação .....	11

## 1. EXAME PRELIMINAR

Retire o medidor e acessórios da embalagem e examine-os cuidadosamente. Para obter assistência técnica, contate a Assistência Técnica Hanna Instruments ou envie um e-mail para [assistencia@hanna.pt](mailto:assistencia@hanna.pt).

Cada HI9810392 é fornecido com um conjunto inicial que inclui:

- Solução padrão pH 4.01, saquetas de 20 mL (2 un.)
- Solução padrão pH 7.01, saquetas de 20 mL (2 un.)
- Solução de limpeza e desinfecção de Eléttodos para depósitos de chocolate, saquetas de 20 ml (2 un.)
- Solução de armazenamento para eléttodos, frasco conta-gotas de 13 mL (1 un.)
- Solução eletrolítica em gel, frasco conta-gotas de 13 mL (1 un.)
- Pilha de lítio 3V - CR2032
- Certificado de qualidade do instrumento e Manual de instruções.

*Nota: Guarde todas as embalagens até ter a certeza de que o medidor funciona corretamente. Qualquer item danificado ou defeituoso deve ser devolvido na sua embalagem original, juntamente com os acessórios fornecidos.*

## 2. ESPECIFICAÇÕES

Gama	pH	0,00 a 12,00 pH
	mV *	Conversão pH/mV
	Temperatura**	0,0 a 60,0 °C (32,0 a 140,0 °F)
Resolução	pH	pH 0,01 ou 0,1
	mV *	0,1 ou 1 mV
	Temperatura	0.1 °C; 0.1 °F
Precisão	pH	±0.05 pH
	Temperatura	±0.5 °C; ±0.9 °F
Calibração	Até três pontos ou quatro pontos	
	Autorechecimento de padrões predefinidos Hanna (pH 1.68 *, 4.01, 7.01, 10.01) ou NIST (pH 1.68 *, 4.01, 6.86, 9.18)	
Compensação da temperatura	Automática (ATC) ou Manual (MTC) *	
Eléttodo	Material do corpo	Fluoreto de polivinilideno (PVDF)
	Vidro	Baixa temperatura (LT)
	Junção	Aberta
	Célula de Referência	Dupla, Ag/AgCl
	Eletrólito	Gel (de encher)
	Ponteira/ Formato	cônica, Ø 5 x 10 mm (Ø 0,19 x 0.39")
	Diâmetro exterior	12 mm (0.47")
Comprimento	75 mm (2.95")	
Tipo de pilha	lítio 3V - CR2032	
Duração da pilha	Aproximadamente 1000 horas de autonomia (500 horas com o Bluetooth ativo)	
Ambiente de utilização	0 a 50 °C (32 a 122 °F)	
Caixa do equipamento	Proteção à permeabilidade IP65	
Dimensões	51 x 150 x 21 mm	
Peso	45 g	

\* Disponível com a App Hanna Lab

\*\* A medição fora da gama de temperatura operacional recomendada pode danificar o eletrólito do gel e anular a garantia do produto.

*Nota: O medidor apresenta medições desde -2.00 a 16.00 pH. Medições fora da gama de pH são indicadas a intermitente. Neste caso, avalie a integridade do medidor e o tipo de amostra medida.*

### 3. DESCRIÇÃO GERAL E FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

O HI9810392 é um medidor de pH profissional sem fios (Wireless), da família HALO2 da Hanna Instruments.

- O Bluetooth integrado permite a conexão do medidor a um dispositivo smart compatível com a aplicação Hanna Lab
- O medidor apresenta um corpo compacto, com proteção à água e calibração de pH automática até três ou quatro pontos quando utilizado com a App Hanna Lab
- As leituras automaticamente compensadas pela temperatura são apresentadas no amplo ecrã LCD.
- Preciso e fácil de utilizar, medidor é ideal para medições de pH durante o processo de produção de chocolate.

#### Modo de Funcionamento

O HI9810392 pode ser utilizado como um medidor de pH autónomo ou conectado à App Hanna Lab.

A App Hanna Lab transforma um dispositivo compatível num medidor de pH profissional. As suas funções incluem: condição do eletrodo, BPL com carimbo de data/ hora, leituras ao vivo, resolução de mV, compensação manual de temperatura, critério de estabilidade, lembrete de calibração, alarmes de pH (mV) e temperatura, ID do medidor e partilha de dados.

#### Características da sonda

O corpo do eletrodo resistente em PVDF é fácil de limpar. Resistente à maioria de químicos (por ex. solventes, incluindo hipoclorito de sódio), à radiação ultravioleta e ao crescimento fúngico, o seu corpo em PVDF possui também uma grande resistência à abrasão e força mecânica.

A sua **extremidade cônica** permite uma fácil penetração em sólidos e semissólidos.


A **manga de junção externa em PVDF** pode ser removida e limpa. Quando limpa, é adicionada uma pequena quantidade de eletrólito em gel e a junção fica renovada, melhorando a medição e prolongando a vida do medidor.

O design da **junção dupla** apresenta uma solução de eletrólito livre de prata interagindo com a amostra, tornando o eletrodo menos suscetível a entupimento e garantindo uma resposta rápida e leitura estável.


O **sensor de temperatura** incorporado na extremidade do eletrodo de pH permite a rápida determinação da temperatura da amostra e uma leitura da temperatura altamente precisa.

### 4. DESCRIÇÃO FUNCIONAL & ECRÃ LCD

Vista lateral e traseira

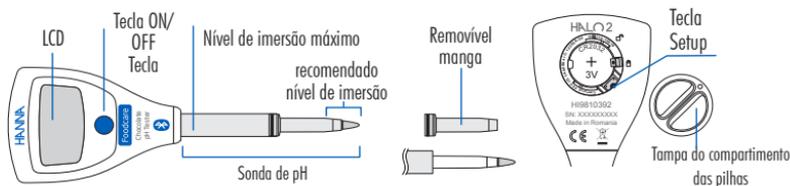

Mostrador LCD

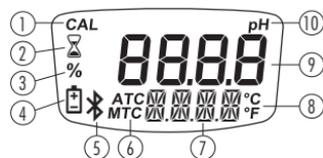

- |   |                                   |    |                            |
|---|-----------------------------------|----|----------------------------|
| 1 | Indicador de calibração           | 6  | Compensação da temperatura |
| 2 | Indicador de estabilidade         | 7  | Segunda linha do LCD       |
| 3 | Indicador da percentagem da pilha | 8  | Unidade de temperatura     |
| 4 | Ícone da pilha.                   | 9  | Primeira linha do LCD      |
| 5 | Ícone do Bluetooth                | 10 | Unidade de medição         |

## 5. OPERAÇÕES GERAIS


### Ligar e Desligar o medidor (ON/OFF)

- Vire o medidor para baixo numa superfície limpa e seca. Rode a tampa do compartimento das pilhas, no sentido anti-horário e coloque-a. Remova a película de filme das pilhas.
- Prima a tecla ON/OFF para ligar ou desligar o medidor. O ecrã de início apresenta todos os ícones, seguido pela percentagem da pilha. O medidor entra em modo de medição. Antes do medidor se desligar, "OFF PWR" é exibido por breves momentos.
- Prima e mantenha premida a tecla ON/OFF para desligar o medidor quando conectado ao Bluetooth.

### Substituição da pilha

1. Desligue o medidor. Vire o medidor para baixo e rode o compartimento das pilhas no sentido anti-horário.
2. Coloque a tampa da bateria de lado. Prima o pino metálico para empurrar a bateria usada para fora.
3. Coloque a nova pilha com o (+) voltado para cima.
4. Redefina a data e a hora nas definições ou conecte-se à App Hanna Lab para atualizá-lo automaticamente.
5. Alinhe a marca na tampa com o ícone de cadeado aberto (☞) na caixa. Rode a tampa no sentido horário até que a marca na tampa se alinhe com o ícone de cadeado fechado (🔒).

*Nota: Use apenas o tipo de pilha especificado. Elimine a pilha esgotada em conformidade com os regulamentos locais.*



## 6. DEFINIÇÕES

A tecla Setup (definições) encontra-se localizada dentro do compartimento das pilhas. Após a configuração das definições, volte a colocar a tampa.

### Navegação no menu definições

- Prima a tecla Setup para aceder ao menu Setup e navegar pelos itens.
- Para sair do modo Setup, prima a tecla Setup após a opção "SET TIME" for exibida.
- Prima a tecla ON/OFF para configurar as opções do item do menu.

### Unidade de Temperatura

Opção: °C ou °F

Prima a tecla ON/OFF para selecionar a unidade de temperatura desejada.



### Intervalo Auto-off

Opção: 8, 60 min., ou "----" (desativado)

Prima a tecla ON/OFF para selecionar o intervalo desejado. Para poupar a pilha, após ter passado o intervalo auto-off



Selecioneado, o medidor desliga-se automaticamente

### Pontos de calibração

Opção: 2P ou 3P


Prima a tecla ON/OFF para selecionar entre até dois ou até três pontos de calibração.



### Conjunto de padrões

Opção: 7.01 pH (Hanna) ou 6.86 pH (NIST)


Prima a tecla ON/OFF para selecionar o conjunto de padrões de calibração (Hanna ou NIST).



### Resolução de pH

Opção: 0.01 pH ou 0.1 pH

Prima a tecla ON/OFF para selecionar Resolução.



### Bluetooth Modo Wireless

Opção: On, PAIR, ou OFF

Prima a tecla ON/OFF para selecionar a opção Bluetooth no início.



## Emparelhamento Bluetooth

**Opção: dEL PAIr**

Prima a tecla ON/OFF para apagar um aparelho emparelhado guardado.




## Data e Hora

**Opção: SEt TIME** (ajustar hora)

Prima a tecla ON/OFF para ajustar a data e hora.

**Opção: ANO, MÉS, DIA, HORA e MIN**

Use a tecla Setup (definições) para selecionar a opção e prima a tecla ON/OFF para alterar a opção selecionada.



## 7. BLUETOOTH

Com "PAIr r BLU" ou "ON BLU" selecionado em Setup, o ícone Bluetooth (⌘) é exibido a intermitente até 45 segundos, indicando que o medidor está no modo detetável. Uma vez conectado, o ícone para de piscar. Caso não esteja conectado, o ícone não é exibido.

- Selecione "ON BLU", para ativar o Bluetooth sem vinculação.
- Selecione "PAIr r BLU", para ativar o Bluetooth com vinculação. É exibido um pin de vinculação de 6 dígitos na primeira vez que o medidor é emparelhado ao dispositivo smart. Uma vez emparelhados os dispositivos, o pin não é mais solicitado quando conectados.
- Selecione "OFF BLU", para desativar o Bluetooth.
- Selecione "dEL PAIR", para apagar todos os dispositivos emparelhados. Caso PAIr BLU esteja ativo, será solicitado um pin de vinculação.


## 8. APP HANNA LAB

- A aplicação Hanna Lab encontra-se disponível na App Store® e no Google Play.
- Consulte a secção Help (Ajuda) da aplicação para mais informação sobre calibração, medição, registo de dados e partilha.
- Quando o medidor encontra-se em modo detetável, aparecerá na lista dos "Available Devices" (dispositivos disponíveis).
- Na aplicação, clique em "Conectar" para emparelhar o medidor com o dispositivo. Todas as leituras são transmitidas diretamente para a aplicação.

### Identificar uma medição (tag)

Uma vez conectado à aplicação, a tecla ON/OFF pode ser premeida para identificar a leitura atual.

- Prima a tecla ON/OFF desde o modo de medição. O ecrã apresenta "SEt TAG", seguido de "- TAG".
- A leitura na aplicação é apresentada a verde e o ícone de notas (📌) é exibido. Clique no ícone de notas (📌) para adicionar uma nota.



## 9. CALIBRAÇÃO

### Diretrizes para a Preparação

1. Retire o elétrodo do tubo plástico de armazenamento. Guarde a tampa para o armazenamento do elétrodo.
2. Enxague qualquer solução de armazenamento ou sais que possam estar presentes no corpo.
3. Verifique se existe solução dentro do bulbo de pH, sacudindo cuidadosamente o elétrodo para restaurar a continuidade da solução, pois pode se ter deslocado pela haste do elétrodo durante o transporte.
4. Para melhores resultados, utilize um copo graduado seco e um copo de calibração separado para cada padrão. Descarte os padrões após a utilização.

### Procedimento

Para a maioria das aplicações, recomendamos iniciar com o padrão pH 7,01 (ou pH 6,86).

Para restaurar os padrões de fábrica, prima e mantenha premeida a tecla ON/OFF. É indicado "CAL CLR".

*Nota: Recomenada-se calibrar o elétrodo com os padrões à temperatura em que será utilizado.*

App Store é uma marca registada da Apple, Inc.

Google Play e o logotipo Google Play são marcas registadas da Google LLC.

## Medidor autónomo (Calibração até três pontos)

1. Enxague a ponteira do eléctrodo com água purificada e seque. Depois enxague com o padrão que usou para a calibração.
2. Prima a tecla ON/OFF até que seja exibido "CAL MODE".
3. Quando "7.01 USE" ou "6.86 USE" é indicado com o ícone "CAL" a intermitente, coloque a ponteira do eléctrodo no padrão atual.



4. Quando o padrão é reconhecido, exibe "REC".  
"WAIT" é indicado com o indicador de estabilidade (Σ) a intermitente até que a leitura seja estável. Aguarde até que a medição esteja armazenada e o indicador de estabilidade desapareça.



5. Para guardar a calibração a um ponto e voltar ao modo de medição, prima a tecla ON/OFF.  
"CAL SAVE" é exibido por breves segundos.

### Com a opção 2P selecionada

6. Coloque a ponteira do eléctrodo no segundo padrão, e depois no segundo padrão de calibração. Aguarde até que a medição esteja armazenada e o indicador de estabilidade desapareça.
7. Após o armazenamento do segundo ponto, "CAL SAVE" é exibido por breves segundos e o medidor volta automaticamente ao modo de medição.

### Com a opção 3P selecionada

6. Coloque a ponteira do eléctrodo no segundo padrão, e depois no segundo padrão de calibração. Aguarde até que a medição esteja armazenada e o indicador de estabilidade desapareça.
7. Coloque a ponteira do eléctrodo no terceiro padrão, e depois no terceiro padrão de calibração. Aguarde até que a medição esteja armazenada e o indicador de estabilidade desapareça.
8. Após o armazenamento do terceiro ponto, "CAL SAVE" é exibido por breves segundos e o medidor volta automaticamente ao modo de medição.

## Com a App Hanna Lab (Calibração até quatro pontos)

Conecte o medidor à App Hanna Lab e siga o procedimento de calibração.  
Consulte a secção Help (Ajuda) da aplicação para ver o procedimento de calibração.

## 10. CUIDADOS E MANUTENÇÃO


- Nunca mergulhe o medidor mais do que o nível de imersão máximo indicado.
- Deve ser utilizado um padrão novo para cada calibração. Uma vez aberta a saqueta o valor do padrão pode alterar-se ao longo do tempo.
- Se o eléctrodo estiver lento, mergulhe-o na solução de limpeza por 20 minutos. Enxague com água e hidrate a sonda em solução de armazenamento, durante 30 minutos no mínimo, antes de realizar a calibração.
- Se as medições são efetuadas sucessivamente, recomenda-se enxaguar bem a sonda em água destilada ou desionizada, de modo a prevenir a contaminação cruzada.

### Encher o eletrodo

- Para remover a manga do eletrodo, gire-a com cuidado e deslize-a para fora (A). Coloque-o de lado.

*Nota: Manuseie a sonda com cuidado, a haste do eletrodo de pH é feita de vidro.*

- Enxague quaisquer vestígios de gel eletrolítico da manga. Mergulhe a ponteira do eletrodo em solução de limpeza de uso geral HI700601 (ou HI700661, HI700663, HI700664) durante 20 minutos. Enxague com água destilada ou desionizada.
- Volte a encher a célula de referência com solução eletrolítica em gel HI9071 (B).
- Volte a colocar a manga. Assegure-se que O-ring está bem encaixado no eletrodo. Enxague o excesso de gel com água destilada ou desionizada.
- Agite a sonda cuidadosamente para eliminar quaisquer bolhas de ar.
- Mergulhe o eletrodo em solução de armazenamento durante um mínimo de 30 minutos, antes de calibrar.



### Armazenamento

Para assegurar uma resposta rápida, a ponteira de vidro e junção devem ser mantidos hidratada e não permitir que sequem.

Quando o eletrodo não está a ser utilizado, adicione algumas gotas de solução de armazenamento na tampa de proteção. Se não tiver solução de armazenamento disponível, pode utilizar solução padrão pH 4,01 ou pH 7,01.

*Nota: Nunca armazene o eletrodo em água destilada ou desionizada.*

## 11. MENSAGENS DE ERRO E AVISO



“---- WRNG” exibido durante a calibração.

Padrão inválido.

Verifique o valor do padrão e utilize um padrão novo.



Valor medido exibido a intermitente.

Valor medido fora da gama do eletrodo.

Limpe o eletrodo para melhorar a condição.



Ícone da pilha (🔋) exibido a intermitente.

Pilha abaixo de 10 %, substitua a pilha



“BAtt DEAD” e o medidor desliga-se

Pilha esgotada, substitua a pilha.

## 12. ABREVIATURAS

CAT	Compensação automática da Temperatura
BPL	Boas Práticas Laboratoriais
CMT	Compensação manual da temperatura
NIST	National Institute of Standards and Technology

## 13. ACESSÓRIOS

Como encomendar	Descrição do Produto
<b>Soluções padrão de pH</b>	
HI50016-02	solução padrão pH 1.68, saquetas de 20 mL (25 un.)
HI70004P	solução padrão pH 4.01, saquetas de 20 mL (25 un.)
HI70006P	solução padrão pH 6.86, saquetas de 20 mL (25 un.)
HI70007P	solução padrão pH 7.01, saquetas de 20 mL (25 un.)
HI70009P	solução padrão pH 9.18, saquetas de 20 mL (25 un.)
HI70010P	solução padrão pH 10.01, saquetas de 20 mL (25 un.)
HI77400P	solução padrão pH 4.01 e 7.01, saquetas de 20 ml (10 un., 5 de cada)
HI770710P	solução padrão pH 10.01 e 7.01, saquetas de 20 ml (10 un., 5 de cada)
<b>Solução de Limpeza para Eléttodos</b>	
HI700601P	Solução de limpeza para uso geral, saquetas de 20 ml (25 un.)
HI700685P	Solução de limpeza e desinfecção de Eléttodos para depósitos de chocolate, saquetas de 20 ml (25 un.)
<b>Solução de armazenamento para eléttodos</b>	
HI70300L	Solução de armazenamento, 500 ml
HI70300M	Solução de armazenamento para eléttodos, de 230 mL
HI70300S	Solução de armazenamento para eléttodos, frasco conta-gotas de 30 ml
HI9072	Solução de armazenamento para eléttodos, frasco conta-gotas de 13 ml
<b>Solução de enchimento de eléttodo</b>	
HI9071	Solução eletrolítica em gel, conta-gotas de 13 mL (1 un.)

## RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar este produto, certifique-se da sua total adequação à sua aplicação específica e no ambiente em que o vai utilizar. Qualquer alteração a este instrumento introduzida pelo utilizador pode resultar na degradação do desempenho do medidor de bolso. Para a sua segurança e a do medidor, não utilize nem armazene o instrumento em ambientes perigosos.

## GARANTIA

HI9810392 tem garantia de um ano, contra defeitos de fabrico na manufatura e em materiais, desde que utilizados no âmbito da sua finalidade e manuseados de acordo com as instruções de utilização indicadas. Esta garantia é limitada à reparação ou substituição gratuita do instrumento. Os danos resultantes de acidentes, uso indevido, adulteração ou falta de manutenção recomendada não estão cobertos pela garantia. Caso seja necessária assistência técnica, contacte a Hanna Instruments. Se em garantia, indique o número do modelo, data de aquisição, número de série e a natureza do problema. Se a reparação não se encontrar ao abrigo da garantia, será notificado dos custos decorrentes. Caso pretenda enviar o instrumento à Hanna Instruments, obtenha primeiro uma autorização (RGA) junto do Departamento de Assistência Técnica Hanna. Proceda depois ao envio, com todos os portes pagos. Ao enviar qualquer produto, certifique-se de que ele seja enviado em conformidade com os regulamentos de envio, totalmente limpo e livre de quaisquer produtos químicos, e devidamente embalado para proteção completa.

MAN9810392 10/21

A Hanna Instruments reserva-se o direito de modificar o design, construção e aparência dos seus produtos sem aviso prévio.

## CERTIFICAÇÃO

Todos os produtos Hanna Instruments estão em conformidade com as **Diretivas CE**.

**Eliminação de Equipamento Elétrico e Eletrônico.** O produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. Deve ser reencaminhado para reciclagem no centro de tratamento de resíduos adequado para equipamentos elétricos e eletrônicos.

**Eliminação de resíduos de pilhas.** Este produto contém pilhas, não as elimine juntamente com outros resíduos domésticos. Reencaminhe-as para o centro de tratamento de resíduos apropriado para reciclagem. A correta eliminação do produto e das pilhas previne potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde pública. Para obter mais informações, contacte o centro de tratamento de resíduos da sua área ou o mais próximo.



RoHS  
compliant



### Avisos regulamentares para módulos autônomos, Bluetooth e de baixo consumo

O modo de funcionamento dos módulos idêntico. Todas as referências às regras da FCC dos EUA e aos padrões RSS canadenses sobre classificação e operação de dispositivos, aqui apresentadas no Módulo BMD-300, aplicam-se a todos os modelos mencionados. Retire a tampa do compartimento da pilha para verificar o módulo instalado.

<b>BMD-300 Module</b>	
<b>United States (FCC)</b> FCC ID: 2AA9B04 This device complies with FCC Rules, Part 15, Subpart C "Intentional Radiators" and Subpart B, Chapter §15.105. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case, users are required to correct the interference of their own expense.	
<b>Canada (ISED)</b> IC: 12208A-04 This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation of the device. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.	
<b>Australia / New Zealand (RCM)</b> BMD-300 complies with the AS/NZS 4268:2017.	
<b>Japan (MIC)</b> R210-106799	<b>South Korea (KCC)</b> R-CRM-Rgd-BMD-300
<b>Brazil (ANATEL):</b> Contains ANATEL approved module # 00820-21-05903.	<b>Mexico (IFETEL):</b> Este equipo contiene el módulo con IFT #: NYCE/CT/0146/17/TS.
<b>BMD-350 Module</b>	
<b>United States (FCC)</b> FCC ID: 2AA9B05	
<b>Canada (ISED)</b> IC: 12208A-05	
<b>Japan (MIC)</b> R210-108944	<b>Australia / New Zealand (RCM)</b> BMD-350 complies with the AS/NZS 4268:2017
<b>Eurasia (EAC)</b> EA0C N RU JL-US. HA27.B.00650/18	<b>Brazil (ANATEL)</b> Contains ANATEL approved module # 00857-21-05903
<b>China (SRRC)</b> CMIIT ID: 2018DJ7255	<b>Mexico (IFETEL)</b> Este equipo contiene el módulo con IFT #: RCRPBM18-1491
<b>ANNA-B112 Module</b>	
<b>United States (FCC)</b> FCC ID: XPYANNAB1	
<b>Canada (ISED)</b> IC: 8595A-ANNAB1	
<b>Taiwan (NCC)</b> 內含發射器模組: CCA118LP2200T2	<b>South Korea (KCC)</b> R-C-ULX-ANNA-B112
<b>South Africa (ICASA)</b> ICASA TA-2019/1203 Approved	<b>China (SRRC)</b> CMIIT ID: 2021DJ6698
<b>Australia / New Zealand (ACMA)</b> ANNA-B1 complies with AS/NZS 4268:2012 standard	
<b>Japan (MIC)</b> R204-810005	The module complies with the Japanese Technical Regulation Conformity Certification of Specified Radio Equipment (ordinance of MPT N°. 37, 1981), Article 2, Paragraph 1, Item 19 "2.4 GHz band wide band low power data communication system".
ANATEL 03850-19-05903	<b>Brazil (ANATEL)</b> This equipment operates on a secondary basis and, consequently, must accept harmful interference, including from stations of the same kind, and may not cause harmful interference to systems operating on a primary basis.



## Contatos

Hanna Instruments Portugal Lda.  
Zona Industrial de Amorim  
Rua Manuel Dias, Nº 392, Fração I  
4495 - 129 Amorim - Póvoa de Varzim  
[www.hanna.pt](http://www.hanna.pt)